Q-PALL PLASTIC PALLETS


Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette hygiénique 1200 x 800 x 160 plateau fermé 3 semelles heavy, rayonnage 1.000 kg – bleu

HEAVY | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS

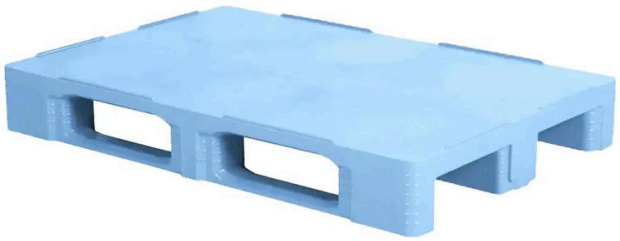

DESSOUS



7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QPH1208HP3RR-CDB
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	160 mm
Poids	18 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau fermé
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique vierge
Couleur	Bleu
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 800 x 2385 mm)

VERSIONS SIMILAIRES


RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
QPH1208HP3RR-CDB Cette fiche	Bleu	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDG	Gris	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HR3RR-ECO	Noir	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette hygiénique 1200 x 800 x 160 plateau fermé 3 semelles heavy, rayonnage 1.000 kg – bleu

DESSIN TECHNIQUE

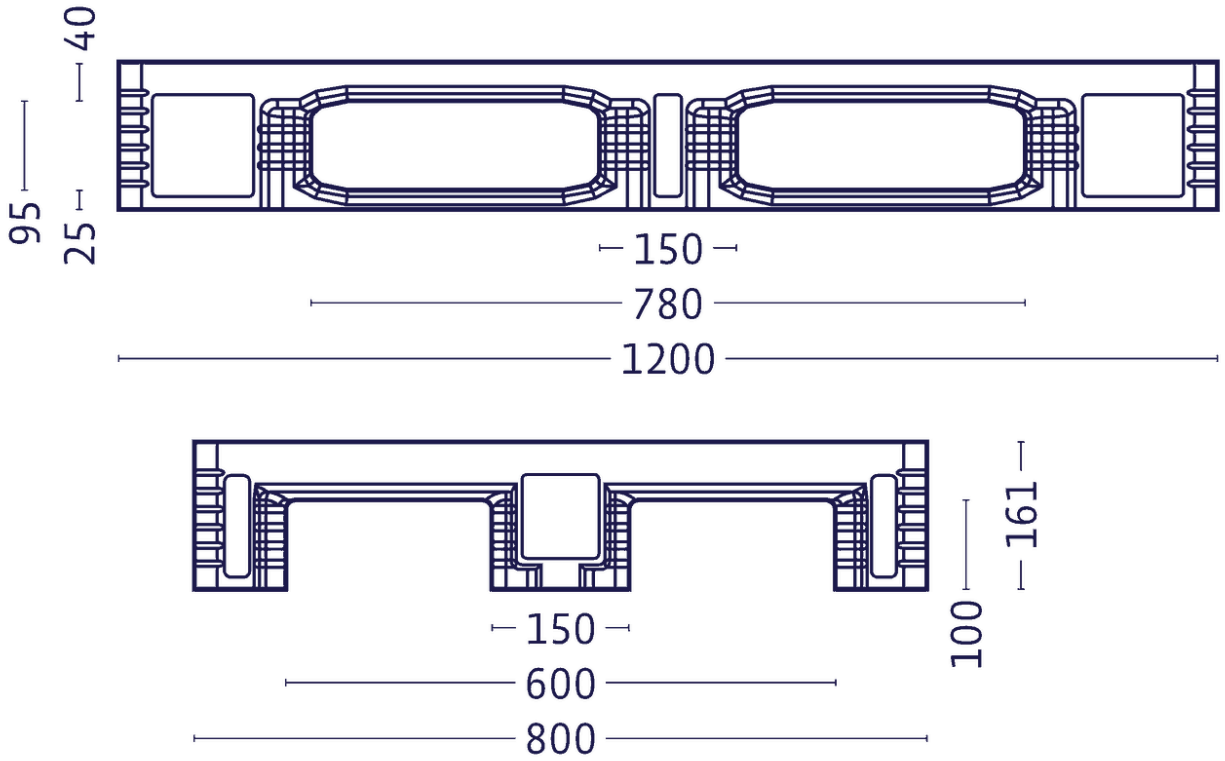

Vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.